IT IMPLANT

IT-SE Implant System General Catalog
ITS Implant System General Catalog

Design of IT Implant comes from Social challenges of Patients and Dentists.

飯島俊一先生による長年の臨床経験に基づく独自の研究開発から、口腔内の経年的変化に対応できる予知性が高い逆テーパーロック型インプラントの「IT-SE Implant」、「ITS Implant」を開発。

飯島 俊一 先生

アイ・ティー・デンタルクリニック院長
日本補綴歯科学会 指導医・専門医
日本口腔インプラント学会 指導医・専門医
東京歯科大学口腔インプラント科臨床教授
ITI (The International Team for Implantology) フェロー

材質:医療用64チタン合金(Ti6AL-4V)

より細く・強く

医療用チタン合金の採用でより高強度に

あらゆる骨質へ

豊富なサイズバリエーションと術式

インプラント周囲炎のリスク軽減

強固なエクスターナルテーパーロック構造

SURFACE



SAG

最適な表面性状

SAG Surfaceが早期の骨形成、
強固な骨結合を実現



BiO®

薄膜ハイドロキシアパタイトコーティング

独自の技術である熱分解法
による薄膜HAコーティング技術

CONTENTS

IT-SE Implant ---- 3
IT-SE Fixture ---- 4
ITS Implant ---- 5
ITS Fixture ---- 6
ITS Joint Abutment & ITS Cap ---- 7
IT Abutment ø2.8 ---- 8
IT-SE埋入ツール/ITS埋入ツール (ITSアバットメントゲージ) ---- 9
Instrument for IT-SE/ITS Implant System ---- 10・11
Drill for IT-SE/ITS Implant System ---- 12
Drill and Tapping for IT-SE/ITS Implant System (ITボーンミルø2.8用) ---- 13

IT-SE Implant (IT-Submerged Extra)

IT-SE Fixture

材質：チタン合金
γ線滅菌済み

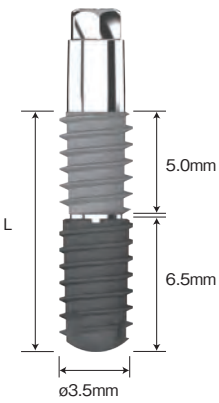

IT-SEフィクスチャ1 ø3.5 NC

骨内長(L)	商品コード
L12	IEF35NC-00120

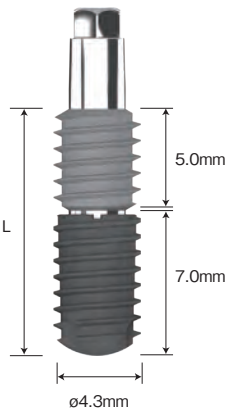

IT-SEフィクスチャ1 ø4.3 RC

骨内長(L)	商品コード
L12	IEF43RC-00120

※骨内長L12と表記していますが、実寸は0.35mm深く埋入されます。

ITS Implant (ITSubmerged)

ITS Fixture

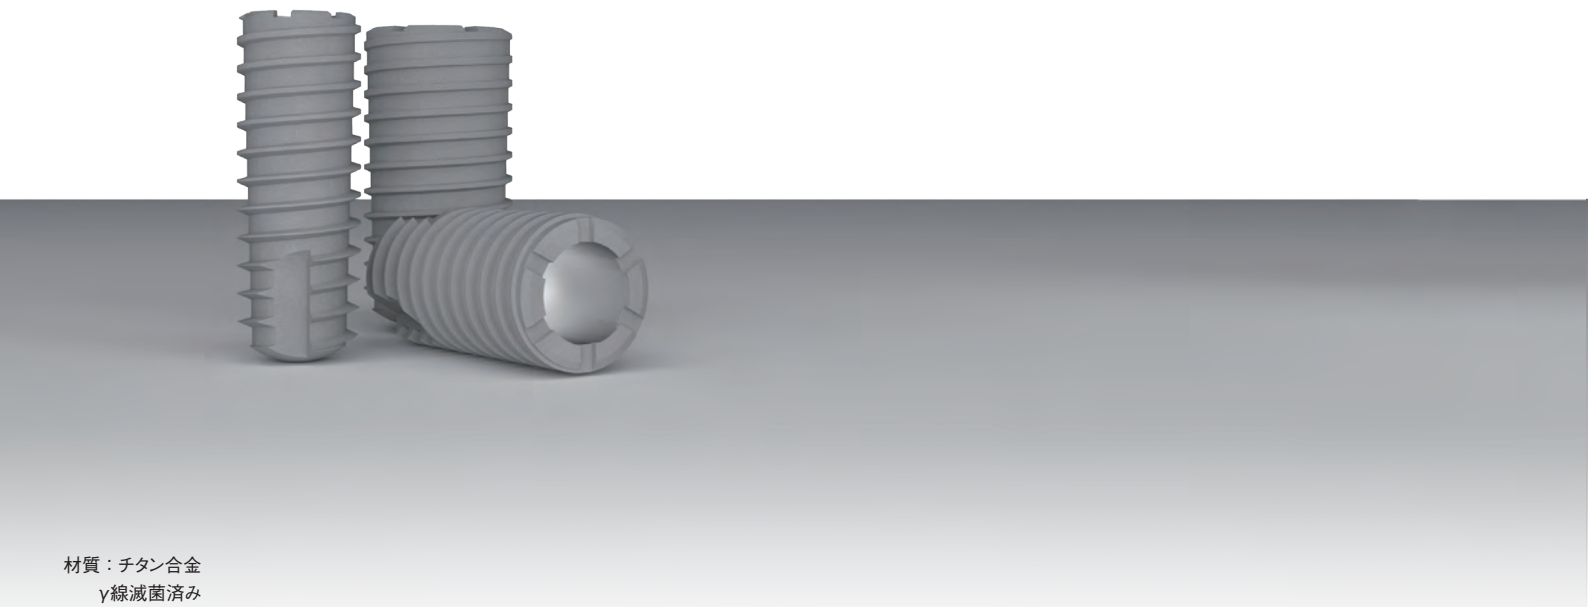

材質：チタン合金
γ線滅菌済み

ITSフィクスチャ φ3.5 NC

骨内長(L)	商品コード
6.5mm	ISF35NC-00060
8mm	ISF35NC-00080
10mm	ISF35NC-00100

ITSフィクスチャ φ4.3 RC

骨内長(L)	商品コード
8mm	ISF43RC-00080
10mm	ISF43RC-00100

ITSフィクスチャ φ4.9 RC

骨内長(L)	商品コード
8mm	ISF49RC-00080
10mm	ISF49RC-00100

ITS Joint Abutment & ITS Cap

材質：チタン合金（未滅菌）

ITS フィクスチャø3.5 NC用

ITSジョイント アバットメント ø2.8 NC



H	商品コード
0.5mm	ISAJANC-28050
1.5mm	ISAJANC-28150
3.0mm	ISAJANC-28300
4.5mm	ISAJANC-28450

ITSプラットフォームキャップ NC

商品コード
ISAPCNC-00000

ITSヒーリングキャップ φ2.8 NC



H	商品コード
1.5mm	ISAHCNC-28150
3.5mm	ISAHCNC-28350

ITS フィクスチャ ø4.3/ø4.9 RC用

ITSジョイント アバットメント ø2.8 RC

H	商品コード
0.5mm	ISAJARC-28050
1.5mm	ISAJARC-28150
3.0mm	ISAJARC-28300
4.5mm	ISAJARC-28450

ITSプラットフォームキャップ RC

商品コード
ISAPCRC-00000

ITSヒーリングキャップ φ2.8 RC



H	商品コード
1.5mm	ISAHCRC-28150
2.0mm	ISAHCRC-28200
3.5mm	ISAHCRC-28350

IT Abutment ø2.8

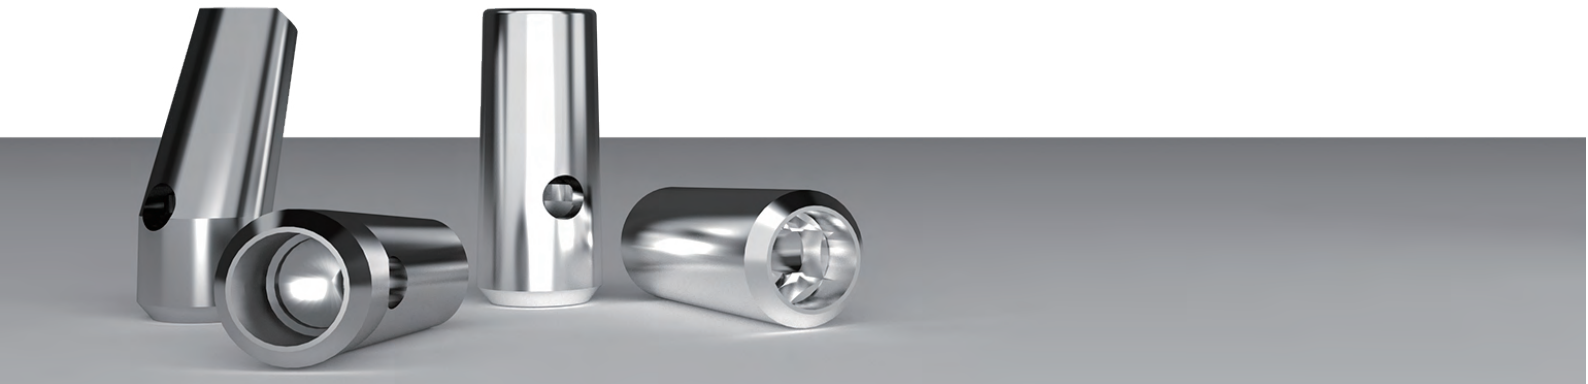

材質：チタン合金（未滅菌）

E Engage Type

単冠修復における位置決めの6角インデックスと回転防止機構を付与

ø2.8ストレートアバットメント1.3°	ø2.8アングルアバットメントA	ø2.8アングルアバットメントB	ø2.8ヒーリングキャップ
	(アングル15°)	(アングル15°)	
商品コード ITA28TS-E1090	ITA28TL-AA09E	ITA28TL-AB09E	ITA28TC-4300E

NE Non Engage Type

インデックスが付与されていない連結修復物専用のアバットメント

ø2.8ストレートアバットメント1.3°	ø2.8アングルアバットメントA	ø2.8アングルアバットメントB	ø2.8ガムフォーマーキャップ ø5.6
	(アングル15°)	(アングル15°)	
ITA28TS-N1090	ITA28TL-AA09N	ITA28TL-AB09N	ITA28GC-5650N

ø2.8アングルアバットメントは15°の傾斜を付与しております。また操作性、及び審美性を考慮しAは屈曲側にBは伸展側にリムーバーホールを設けております。

IT-SE埋入ツール

IT埋入ツール

IT-SEフィクステャ1の植立、およびITSジョイントアバットメントの装着を行うためのツールです。

（IT-SEフィクスチャ1　推奨植立トルク　30Ncm以下）
（ITSジョイントアバットメント　推奨締結トルク　25−30Ncm）

材質：チタン合金



サイズ(全長)	商品コード
S （14mm）	ITIT-RA141
M （21mm）	ITIT-RA211
L （28mm）	ITIT-RA281

ITS埋入ツール

ITS埋入ツール

ITSフィクスチャに装着し、植立を行うためのツールです。
ITSフィクスチャへの締結および解除には、ITSホールディングキーを使用します。

（推奨植立トルク　45Ncm以下）

材質：ステンレス鋼

※1mm間隔

ITS 埋入ツールø3.5

本体全長	スクリュー全長	商品コード
24mm	33mm	ISI35IT-RA330

ITS 埋入ツールø4.3

本体全長	スクリュー全長	商品コード
24mm	33mm	ISI43IT-RA330

ITS 埋入ツールø4.9

本体全長	スクリュー全長	商品コード
24mm	33mm	ISI49IT-RA330

ITS アバットメントセレクトゲージ

歯肉貫通部の高さ(H)を計測し適切なサイズのITSジョイントアバットメントを選択するために使用します。

材質：チタン合金

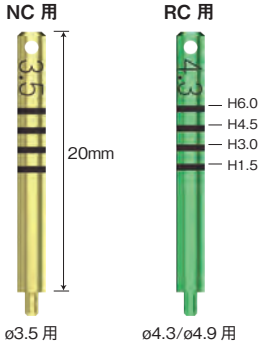

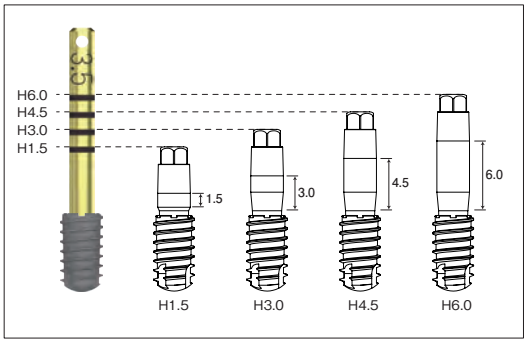

	商品コード
ITSアバットメントセレクトゲージ NC	ISIASNC-00000
ITSアバットメントセレクトゲージ RC	ISIASRC-00000

IT-SE/ITS Implant

Instrument for IT-SE/ITS Implant System

ITパラレルツール

材質：ステンレス鋼

ITインプラントを平行に埋入するための補助ツールです。
インプラント間距離に合わせてサイズ(D)を3種類から選択可能です。
ITツイストドリルφ2.2を使用します。

サイズ(D)	商品コード
7.0mm	ITPT-00700
7.5mm	ITPT-00750
8.0mm	ITPT-00800

ITヒーリングキャップホルダー

材質：チタン合金



ø2.8ヒーリングキャップおよびø2.8ガムフォーマーキャップを口腔内に埋入したIT-SEフィクスチャまたはITSジョイントアバットメントに装着するためのツールです。

商品コード
ITCH-00000

ITテーパリーマ

材質：チタン合金



ITテーパリーマガイドピン

余剰骨及び粘膜を切除するためのツールです。
IT-SEフィクスチャまたはITSジョイントアバットメントに装着し、回転させて使用します。

商品コード
ITRM-00280

ITディセクター

材質：チタン合金



付着した粘膜等を剥離するためのツールです。
IT-SEフィクスチャまたはITSジョイントアバットメントに装着し、回転させて使用します。

商品コード
ITDC-00200

IT印象コーピング (ロング)

材質：チタン合金

IT印象コーピング スクリュー



(単体)

トランスファー印象用のコーピングです。
スクリューの締結、解除には3-Lobeドライバーを使用します。

	商品コード
IT印象コーピング (IT印象コーピングスクリュー付属)	ITIC-00111
IT印象コーピング スクリュー (単体)	ITCS-00110

ITレプリカ (G1.0)

材質：ステンレス鋼



模型用ダミーフィクスチャです。

商品コード
ITRP-00151

IT-SE/ITS Implant

Instrument for IT-SE/ITS Implant System

ITリリースドライバー

材質：チタン合金

IT-SEフィクスチャまたはITSジョイントアバットメントに装着された
φ2.8ヒーリングキャップ、φ2.8ガムフォーマーキャップおよび
IT印象コーピングを外す際に使用するツールです。
時計回りに回転させて、押し出します。

サイズ（全長）	商品コード
M （20mm）	ITRD-RA200
L （25mm）	ITRD-RA250

3・Lobeドライバー

材質：ステンレス鋼



ITSプラットフォームキャップ、ITSヒーリングキャップおよび
IT印象コーピングスクリューの締結および解除に使用します。

サイズ（全長）	商品コード
SS （11mm）	IT3L-HD110
S （20mm）	IT3L-CA190
M （28mm）	IT3L-CA270
L （36mm）	IT3L-CA350

ITリムーバー

材質：ステンレス鋼

ITクラウンリムーバー



商品コード
ITCR-HD001

ITコントラクラウンリムーバー

商品コード
ITCR-CA210

作業模型や口腔内において、ITフィクスチャと嵌合したITアバットメントを解除するためのツールです。ITリムーバーの先端が楕円形状になっています。

ITトルクラチェットS

材質：ステンレス鋼

全長:86mm

トルク管理下でインプラント埋入等を行う際に使用するツールです。

商品コード
ITTR-10000

ITSホールディングキー

材質：ステンレス鋼



全長:80.0mm

スパナ部はITS埋入ツールのインナーピンの解除に使用します。
またピン部はITトルクラチェットSに装着するツール類の支持に使用します。

商品コード
ISI00HK-00000

IT-SE/ITSツールケース

IT-SE/ITSインプラントの埋入に必要なドリル、ツールが全て収納でき
オートクレーブに対応した専用ケースです。

寸法:W203×D142×H62 (mm)

商品コード
ITSC-01000

IT-SE/ITS Implant

Drill for IT-SE/ITS Implant System

ITインプラントドリル

材質：ステンレス鋼

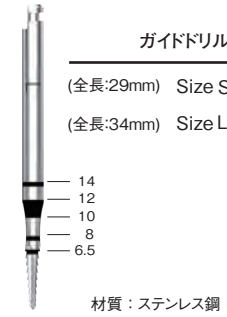

ガイドドリル

(全長:29mm) Size S 100-001S

(全長:34mm) Size L 100-002L

材質：ステンレス鋼

径:ø1.8



ガイドピン

(全長:23mm) Size S 105-0230

(全長:28mm) Size L 105-0280

材質：チタン合金

径:ø1.8

サージカルバー
163RF/014
3001-1631

径:ø1.4
(全長:34mm)

サージカルバー
164RF/018
3001-1641

径:ø1.8
(全長:34mm)

サージカルバー
166RF/021
3001-1661

径:ø2.1
(全長:34mm)

ITパイロットドリルø1.5
ガイド用
ITPGDL-150000

(全長:32mm)



ITパイロットドリルø1.5
ITPTDL-150S00

(全長:32mm)



ITフライスドリルø2.8
ITFSDL-280S00

(全長:34mm)



ITフライスドリル用
ガイドピン
ITFGPN-280000

(全長:17mm)

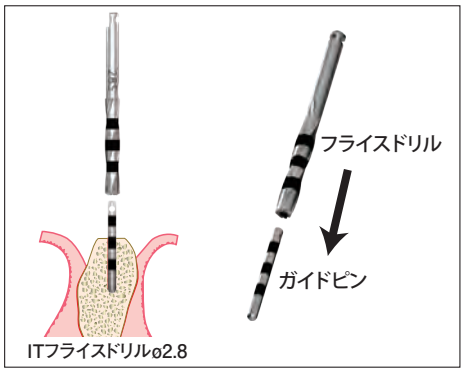



ITツイストドリル
ø2.2
ITTWDL-220S00

(全長:32mm)

ITツイストドリル
ø2.8
ITTWDL-280S00

(全長:32mm)

ITツイストドリル
φ3.5
ITTWDL-350S00

(全長:32mm)

ITツイストドリル
φ4.2
ITTWDL-420S00

(全長:32mm)

IT-SE/ITS Implant

Drill and Tapping for IT-SE/ITS Implant System

For ITS Fixture

材質：ステンレス鋼



ITSファイナルドリル
φ3.5 S
ISFNDL-350S00
（全長:25.5mm）

ITSファイナルドリル
φ4.3 S
ISFNDL-430S00
（全長:25.5mm）

ITSファイナルドリル
φ4.9 S
ISFNDL-490S00
（全長:25.5mm）

For IT-SE Fixture

材質：ステンレス鋼



IT-SEプロファイルドリル
ø3.5
ITPFDL-350S00
（全長:28.5mm）

IT-SEプロファイルドリル
ø4.3
ITPFDL-430S00
（全長:28.5mm）

ITSタッピングインスツルメント

材質：チタン合金

ITS フィクスチャ ø3.5用

ITSストレートタップ
ø3.5



ISI35TP-ST330

ITSテーパータップ
ø3.5



IST35TP-TP300

ITS フィクスチャ ø4.3用

ITSストレートタップ
ø4.3

ISI43TP-ST330

ITSテーパータップ
ø4.3

ISI43TP-TP300

ITS フィクスチャ ø4.9用

ITSストレートタップ
ø4.9

ISI49TP-ST330

ITSテーパータップ
ø4.9

ISI49TP-TP300

ボーンミル

材質：ステンレス鋼

ITボーンミル
φ2.8用
ITTBML-090S00
（全長:26.5mm）



ITツイストドリル

ドリルの機能と構造から、ドリル先端は
インプラントの埋入深度より最大で
0.3mm長くなっています。

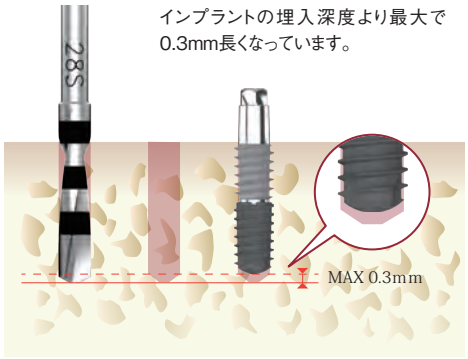

IT-SEプロファイルドリル

IT-SEプロファイルドリルを使用することにより
最大1.0mm深く形成されます。

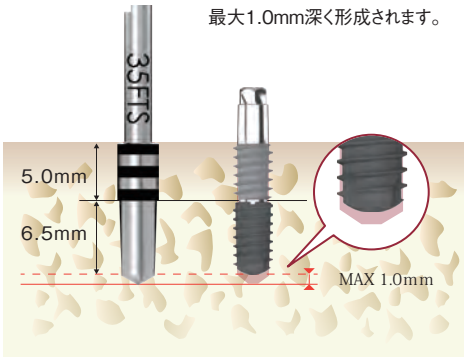

IT-SE/ITS Implant System 承認・認証・届出番号 番号一覧

頁	商品名	一般的名称	販売名	承認・認証・届出番号	クラス分類	製造販売業者
4	IT-SEフィクスチャ	歯科用骨内インプラント材	IT-SEインプラント	30100BZX00109000	高度管理医療機器	(株)プラトンジャパン
6	ITSフィクスチャ	歯科用骨内インプラント材	ITテーパーロックII	22900BZX00314000	高度管理医療機器	(株)プラトンジャパン
7	ITSジョイントアバットメント	歯科用骨内インプラント材	ITテーパーロックII	22900BZX00314000	高度管理医療機器	(株)プラトンジャパン
7	ITSプラットフォームキャップ	歯科用骨内インプラント材	ITテーパーロックII	22900BZX00314000	高度管理医療機器	(株)プラトンジャパン
7	ITSヒーリングキャップ	歯科用骨内インプラント材	ITテーパーロックII	22900BZX00314000	高度管理医療機器	(株)プラトンジャパン
8	ø2.8ストレートアバットメント	歯科用骨内インプラント材	ITインプラント	22600BZX00294000	高度管理医療機器	(株)プラトンジャパン
8	ø2.8アングルアバットメントA	歯科用骨内インプラント材	ITインプラント	22600BZX00294000	高度管理医療機器	(株)プラトンジャパン
8	ø2.8アングルアバットメントB	歯科用骨内インプラント材	ITインプラント	22600BZX00294000	高度管理医療機器	(株)プラトンジャパン
8	ø2.8ヒーリングキャップ	歯科用骨内インプラント材	ITインプラント	22600BZX00294000	高度管理医療機器	(株)プラトンジャパン
8	ø2.8ガムフォーマーキャップ	歯科用骨内インプラント材	ITインプラント	22600BZX00294000	高度管理医療機器	(株)プラトンジャパン
9	IT埋入ツール	歯科用インプラント手術器具	ITインプラント外科用インスツルメント	13B1X10081000049	一般医療機器	(株)プラトンジャパン
9	ITS埋入ツール	歯科用インプラント手術器具	ITインプラント外科用インスツルメント	13B1X10081000049	一般医療機器	(株)プラトンジャパン
9	ITSアバットメントセレクトゲージ	歯科インプラント補綴用器具	ITインプラント補綴用インスツルメント	13B1X10081000050	一般医療機器	(株)プラトンジャパン
10	ITパラレルツール	歯科用インプラント手術器具	ITパラレルツール	13B1X10081000051	一般医療機器	(株)プラトンジャパン
10	ITヒーリングキャップホルダー	歯科インプラント補綴用器具	ITインプラント補綴用インスツルメント	13B1X10081000050	一般医療機器	(株)プラトンジャパン
10	ITテーパリーマ	歯科用インプラント手術器具	ITインプラント外科用インスツルメント	13B1X10081000049	一般医療機器	(株)プラトンジャパン
10	ITディセクター	歯科インプラント補綴用器具	ITインプラント補綴用インスツルメント	13B1X10081000050	一般医療機器	(株)プラトンジャパン
10	IT印象コーピング	歯科インプラント補綴用器具	ITインプラント補綴用インスツルメント	13B1X10081000050	一般医療機器	(株)プラトンジャパン
10	ITレプリカ	歯科インプラント補綴用器具	ITインプラント補綴用インスツルメント	13B1X10081000050	一般医療機器	(株)プラトンジャパン
11	ITリリースドライバー	歯科インプラント補綴用器具	ITインプラント補綴用インスツルメント	13B1X10081000050	一般医療機器	(株)プラトンジャパン
11	3・Lobeドライバー	歯科インプラント補綴用器具	ITインプラント補綴用インスツルメント	13B1X10081000050	一般医療機器	(株)プラトンジャパン
11	ITクラウンリムーバー	歯科インプラント補綴用器具	ITインプラント補綴用インスツルメント	13B1X10081000050	一般医療機器	(株)プラトンジャパン
11	ITコントラクラウンリムーバー	歯科インプラント補綴用器具	ITインプラント補綴用インスツルメント	13B1X10081000050	一般医療機器	(株)プラトンジャパン
11	ITトルクラチェットS	歯科用インプラント手術器具	ITトルクラチェットS	13B1X10081000061	一般医療機器	(株)プラトンジャパン
11	ITSホールディングキー	歯科用インプラント手術器具	ITインプラント外科用インスツルメント	13B1X10081000049	一般医療機器	(株)プラトンジャパン
12	ガイドドリル	電動式歯科用インプラント手術器具	プラトンインプラント・ドリルシステム	22300BZX00073000	管理医療機器	（株）デンテック
12	ガイドピン	歯科用インプラント手術器具	ガイドピン	20B1X00007000001	一般医療機器	（株）ヨシオカ
12	サージカルバー	整形外科用バー	テクニカ サージカルバー	13B2X00094000120	一般医療機器	(株)デンテック
12	ITパイロットドリルø1.5ガイド用	整形外科用バー	ITドリルシステム	13B2X00094000161	一般医療機器	(株)デンテック
12	ITパイロットドリルø1.5	整形外科用バー	ITドリルシステム	13B2X00094000161	一般医療機器	(株)デンテック
12	ITフライスドリルø2.8	整形外科用バー	ITドリルシステム	13B2X00094000161	一般医療機器	(株)デンテック
12	ITフライスドリル用ガイドピン	整形外科用バー	ITドリルシステム	13B2X00094000161	一般医療機器	(株)デンテック
12	ITツイストドリル	整形外科用バー	ITドリルシステム	13B2X00094000161	一般医療機器	(株)デンテック
13	ITSファイナルドリル	整形外科用バー	ITドリルシステム	13B2X00094000161	一般医療機器	(株)デンテック
13	IT-SEプロファイルドリル	整形外科用バー	ITドリルシステム	13B2X00094000161	一般医療機器	(株)デンテック
13	ITSタッピングインスツルメント	歯科用インプラント手術器具	ITインプラント外科用インスツルメント	13B1X10081000049	一般医療機器	(株)プラトンジャパン
13	ITボーンミル ø2.8用	整形外科用バー	ITドリルシステム	13B2X00094000161	一般医療機器	(株)デンテック

・掲載商品の仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更される場合があります。
・掲載商品の画像は必ずしも縮尺どおりではありません。

ご注文について

（フリーダイヤル）
ＦＡＸ受付：0120-36-8952　24時間
電話受付：0120-36-8950　平日（月～金）　午前 9:00 ～ 午後 4:00
※携帯電話からのご利用はできません。
※携帯電話からは042-736-8950（有料）におかけ下さい。

製品のご注文につきましては、FAXまたは電話にてお願い致します。ご注文の際には、以下の項目を正確にお伝えください。

初めてのご注文の場合は、以下の項目を正確にお伝え下さい。

① ITインプラント講習会（講師：飯島俊一先生）受講日
② 郵便番号、ご住所、歯科医院名、院長名、お電話番号
③ ご希望商品の商品コードと製品名
④ 数量

初回以降のご注文の場合は、以下の項目を正確にお伝え下さい。

① 歯科医院または歯科技工所名
② お電話番号
③ ご希望商品の商品コードと製品名
④ 数量

※表示価格は全て税抜価格です。

お届けについて

平日午後 4時までにご注文いただいた製品のお届けは、ご注文日より２営業日後となります。
（北海道、九州、沖縄、離島はご注文日より3営業日後、離島の一部地域はご注文日より3営業日後以降のお届けとなります）

配達エリア	ご注文受付時間	ご注文日より2営業日後	ご注文日より3営業日後
本州・四国	平日 午前 9:00～午後 4:00	●	
北海道・九州・沖縄 離島			●

配達時間につきましては、ヤマト運輸宅急便「時間帯お届け」を利用して、その地域の一番早い配達時間帯でお届けしております。お届け日がお客様の休日にあたっている場合やお届けの時間に不都合がある場合には、ご注文の際にお伝えください。

- 天候、交通事情等によって製品到着が遅れたり、2営業日後の配達が不能となる場合があります。ご入用の製品は余裕をもってご注文願います。2営業日後の配達もしくは時間帯お届けに遅れたことによる責は負いかねますので、予めご了承ください。
- ご注文の製品が品切れの節は、しばらくの猶予をお願い申し上げます。

送料について

- **ご購入金額が30,000円未満（税抜価格）の場合には、送料をご購入金額に加算させていただきます。**

※配達時間を指定される場合はご購入金額に関わらず、別途料金を加算させていただきます。

返品交換について

- 原則としてお受け致しません。
- 製品到着後、ご注文品と一致しているか、破損等がないかなどを速やかにご確認願います。

お支払い方法

- 金融機関振込：当社指定の金融機関にお支払いいただきます。
- 口　座　振　替：（株）日本共同システム(NKS)が収納代行いたします。

※講習会・セミナー受講費については銀行振込のみのお取扱いとさせていただきます。

販売業者

https://it-implant.com/

アイ・ティー株式会社

〒299－0261　千葉県袖ケ浦市福王台2丁目13番地5

TEL：0120-37-7061　FAX：0120-37-7062

製造販売業者

http://www.platonjapan.co.jp

PLATON JAPAN

〒195－0062　東京都町田市大蔵町56　鶴川アカデメイアビル

TEL：042-734-8088 ㈹　FAX：042-734-1109

ご注文・お問合せ

TEL：0120-36-8950

FAX：0120-36-8952

2021.08